

Mitutoyo

AZ ÖN HIVATALOS
VIZSONTELADÓ
PARTNERE:

KALILAB
MÉRÉSTECHNIKA
www.kalilab.hu


- MÉRŐESZKÖZ KERESKEDELEM
- AKKREDITÁLT KALIBRÁLÓ LABOR
- MÉRŐESZKÖZ SZERVIZ

Cím: 2146 Mogyoród, Szadai út 5. ▪ Tel.: +36-20-231-40-46; +36-20-491-55-95 ▪ Email: info@kalilab.hu

MITUTOYO TOP LINE AKCIÓ

Érvényes: 2026.10.31-ig

KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK ÉS
ADATKEZELÉS

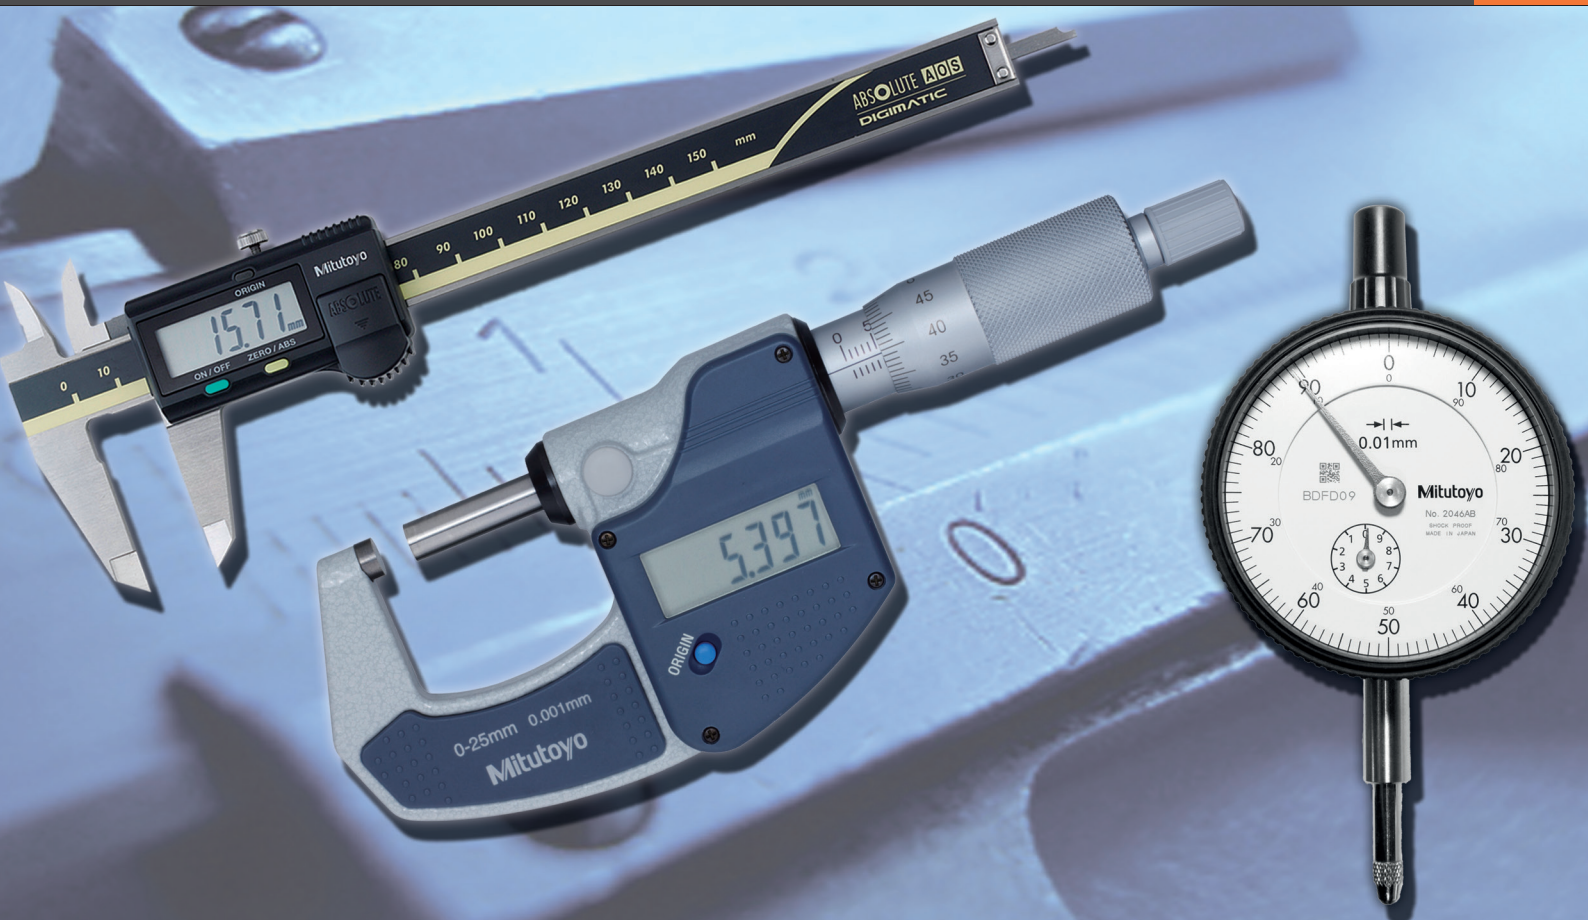

ABSOLUTE AOS Digimatic tolómérő

500-181-30 / 500-184-30

Mérési tartomány 0-150 mm

Digimatic tolómérő a megbízható mérés érdekében.

Jellemzői:

- Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés
- Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez
- Adatkimenet nélkül.
- Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)
- ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást
- Növelt elemélettartam
- Hengeres mélységmérővel (500-184-30)

KALIBRÁLÁS

€ 15,-



500-181-30

Listaár: € 134,-
€ 104,-

500-184-30

Listaár: € 134,-
€ 104,-

Digitális mikrométer 0-25 mm

293-821-30

Sorozat 293

Standard Digimatic mikrométer jellemzői:

- Költséghatékony egyszerű funkcionalitás.
- A racsnis és a frikciós dob garantálja az állandó mérőerőt.
- Adatkimenet nélkül

293-821-30

Listaár: € 196,-
€ 156,-



KALIBRÁLÁS

€ 23,-

KALIBRÁLTASSA MÉRŐESZKÖZEIT A MITUTOYO HUNGÁRIA AKKREDITÁLT KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUMÁBAN!

NEMZETI AKKREDITÁLT HATÓSÁG

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)
a NAIH-2-0341/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve:
Mitutoyo Hungária Kft. Kalibráló Laboratórium
1031 Budapest, Záhony u. 7. D ép. fsz.

2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

3) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. november 5.
Az akkreditált státusz lejárati napja: 2023. november 5.

4) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálások:

Kalibrálható mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Előírt mérési, vagy engedélyezett érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képtelenség μm	A kalibrálási eljárás azonosítója
Hosszmérés			
1. Tolómérők	0 – 1000 mm	Analog: 12...50 μm Digitális: 10...40 μm	KE-ST01-2018
2. Kiegészítő mikrométerek	0 – 300 mm	Analog: 1,6...6,4 μm Digitális: 1,6...6,4 μm	KE-ST02-2018
3. Mértékek, mértéktűk	0 – 100 mm	Analog: 1,1...3,3 μm Digitális: 0,9...2,2 μm	KE-ST03-2018
4. Magasságmérők	0 – 1000 mm	Analog: 12,0...33,0 μm Digitális: 10,0...20,0 μm	KE-ST04-2018
5. Magasságmérőgép	0 – 1000 mm	1,0 μm + 4 L/600	KE-ST05-2018

Budapest, 2018. november 5. 1/2 NAIH-2-0341/2018

Tolómérő 0-150 mm

530-101 / 531-101

Mérési tartomány 0-150 mm

Sorozat 530

Standard tolómérő.

- Mérőfelület és nóniusz matt krómozással.
- Jó siklási képesség.

KALIBRÁLÁS

€ 15,-



530-101

Listaár: € 38,-
€ 31,4,-

531-101

Listaár: € 53,-
€ 41,-

Digitális mérőóra 1207/0,01 mm

543-781B-10

Sorozat 543

Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal.

ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra jellemzői:

- A nullpont beállítása csak egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi.
- Mérési pontosság még nagy sebesség mellett is.
- Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.



KALIBRÁLÁS

€ 21,-

543-781B-10

Listaár: € 193,-
€ 153,-

Mérőóra 10/0,01 mm

2046AB

Mérési tartomány 10 mm

Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőórák osztása 0,01mm, külső méret \varnothing 57 mm.

2046AB

Listaár: € 48,-
€ 39,5,-



KALIBRÁLÁS

€ 18,-

Mitutoyo

Mitutoyo Hungária Kft.

Galamb József utca 9.

2000 Szentendre

Magyarország

www.mitutoyo.eu/hu